


Wyniki badań aparaturowych linii MEDICAL EXPERT anti aging


Poprawa gęstości skóry o **30%**
już po 28 dniach*!

Poprawa gęstości skóry o **44%**
już po 28 dniach*!


Przed

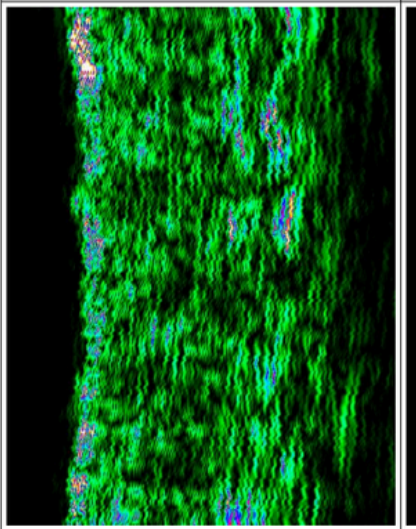


Po

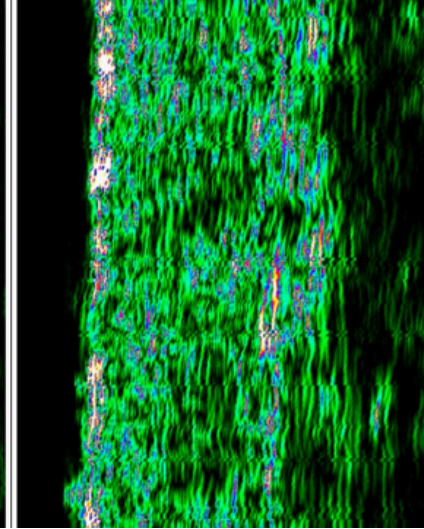

Przed

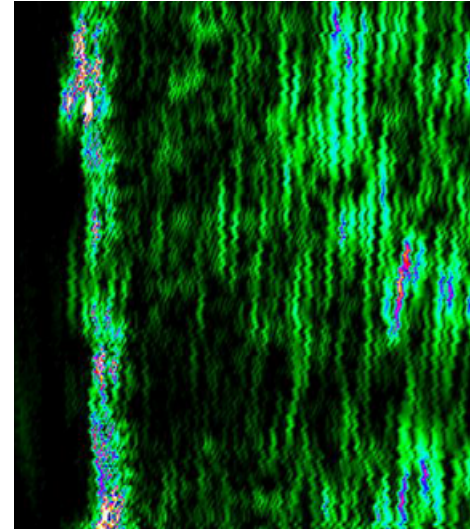

Po

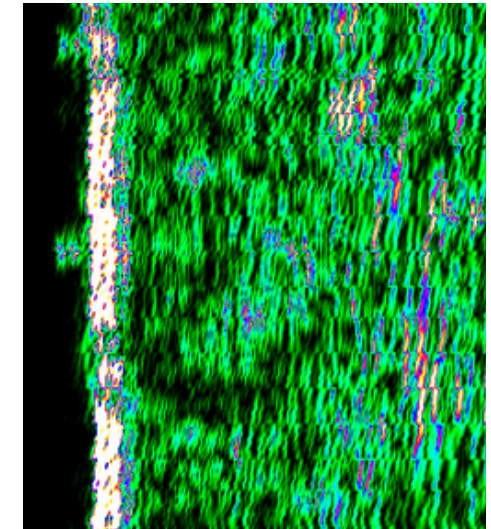

***Badanie aparaturowe,**

wykonane z zastosowaniem analizy ultrasonograficznej gęstości skóry za pomocą Dub®SkinScanner75 przy stosowaniu kosmetyków z linii **Medical Expert anti aging**, tj.:

- **Ampułka** silnie przeciwzmarszczkowa **z peptydem miedziowym** (rano i wieczorem)
- **Emulsja** przeciwzmarszczkowa **z peptydem miedziowym** (rano i wieczorem)

***Badanie aparaturowe,**

wykonane z zastosowaniem analizy ultrasonograficznej gęstości skóry za pomocą Dub®SkinScanner75 przy stosowaniu kosmetyków z linii **Medical Expert anti aging**, tj.:

- **Ampułka** silnie przeciwzmarszczkowa **z peptydem miedziowym** (rano)
- **Emulsja** przeciwzmarszczkowa **z peptydem miedziowym** (rano)
- **Krem** intensywnie odmładzający na noc **z retinoidami** (co wieczór)
- **Krem pod oczy** silnie przeciwzmarszczkowy **z peptydem miedziowym** (rano i wieczór)
- **Krem BB SPF30 z peptydem kolagenowym** (rano)

